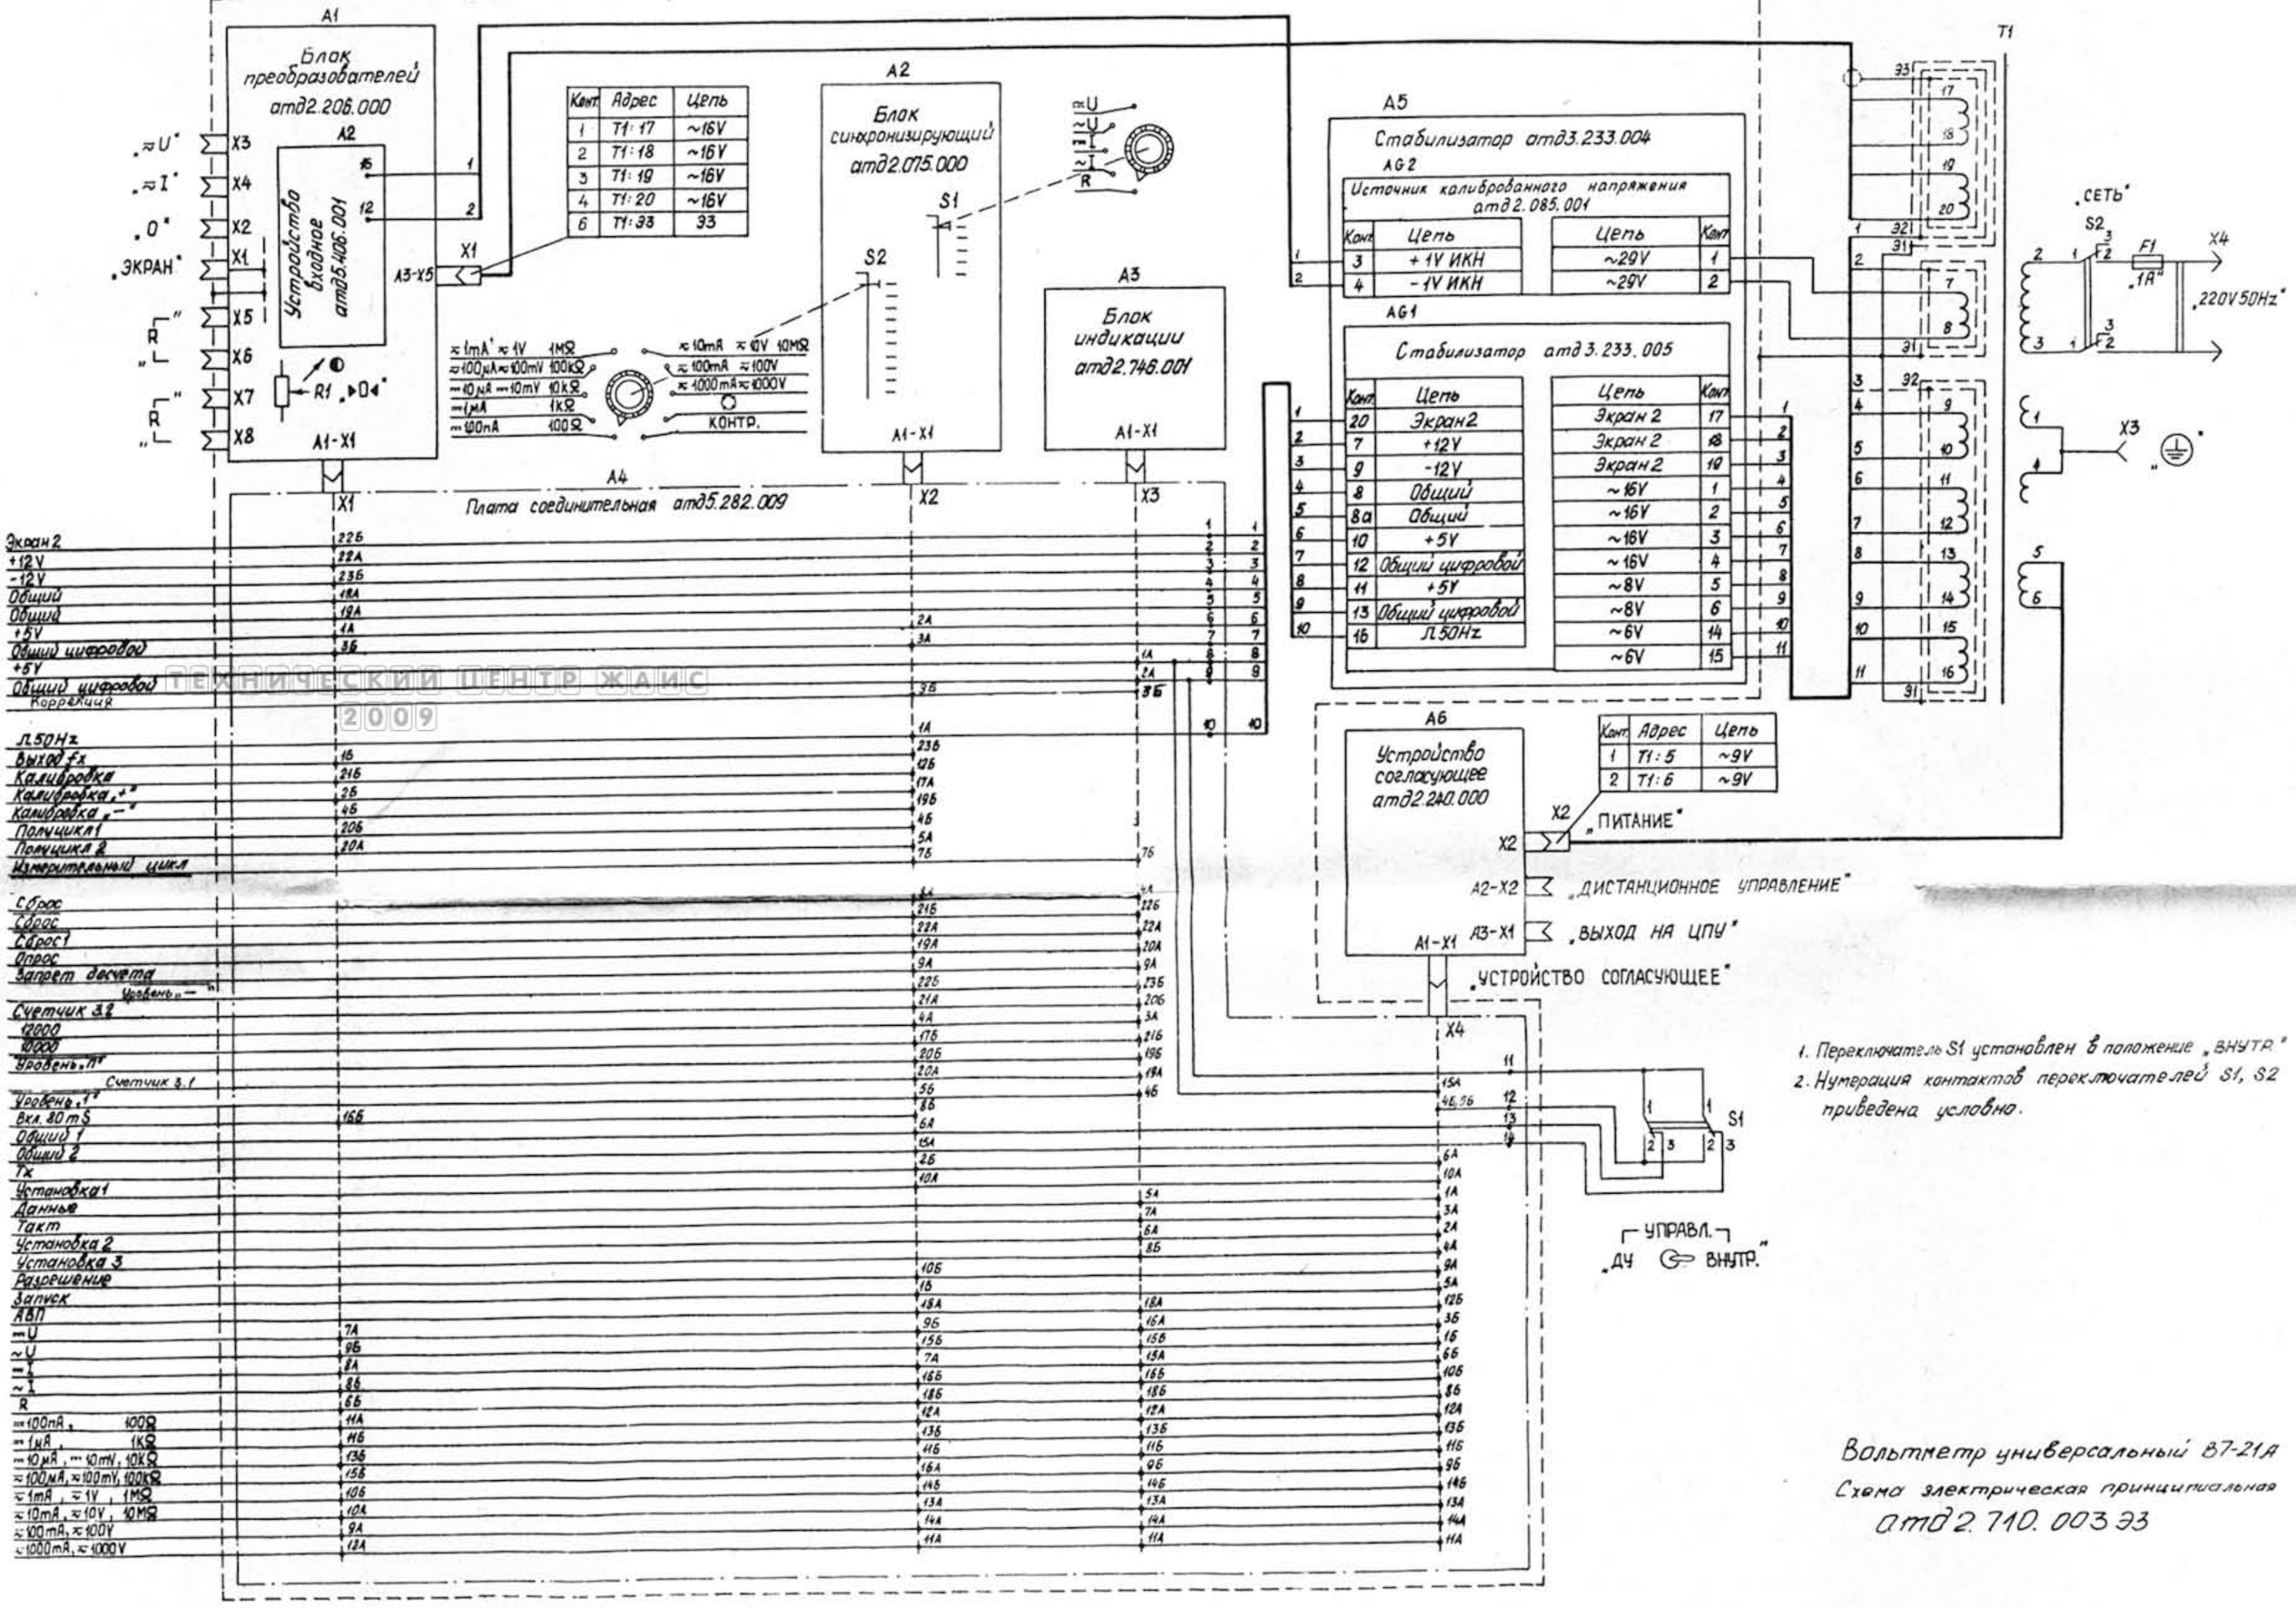

Конт.	Адрес	Цепь
1	Т1: 17	~16V
2	Т1: 18	~16V
3	Т1: 19	~16V
4	Т1: 20	~16V
6	Т1: 33	33

Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
3	+1V ИКН	~29V	1
4	-1V ИКН	~29V	2

Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
20	Экран 2	Экран 2	17
7	+12V	Экран 2	18
9	-12V	Экран 2	19
8	Общий	~16V	1
8а	Общий	~16V	2
10	+5V	~16V	3
12	Общий цифровой	~16V	4
11	+5V	~8V	5
13	Общий цифровой	~8V	6
16	Л50Hz	~6V	14
		~6V	15

Конт.	Адрес	Цепь
1	Т1: 5	~9V
2	Т1: 6	~9V

1. Переключатель S1 установлен в положение „ВНУТР."
2. Нумерация контактов переключателей S1, S2 приведена условно.

Вольтметр универсальный В7-21А
Схема электрическая принципиальная
атд2.710.003 Э3

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС
2009