


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ УСИЛИТЕЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА ГЗ-109

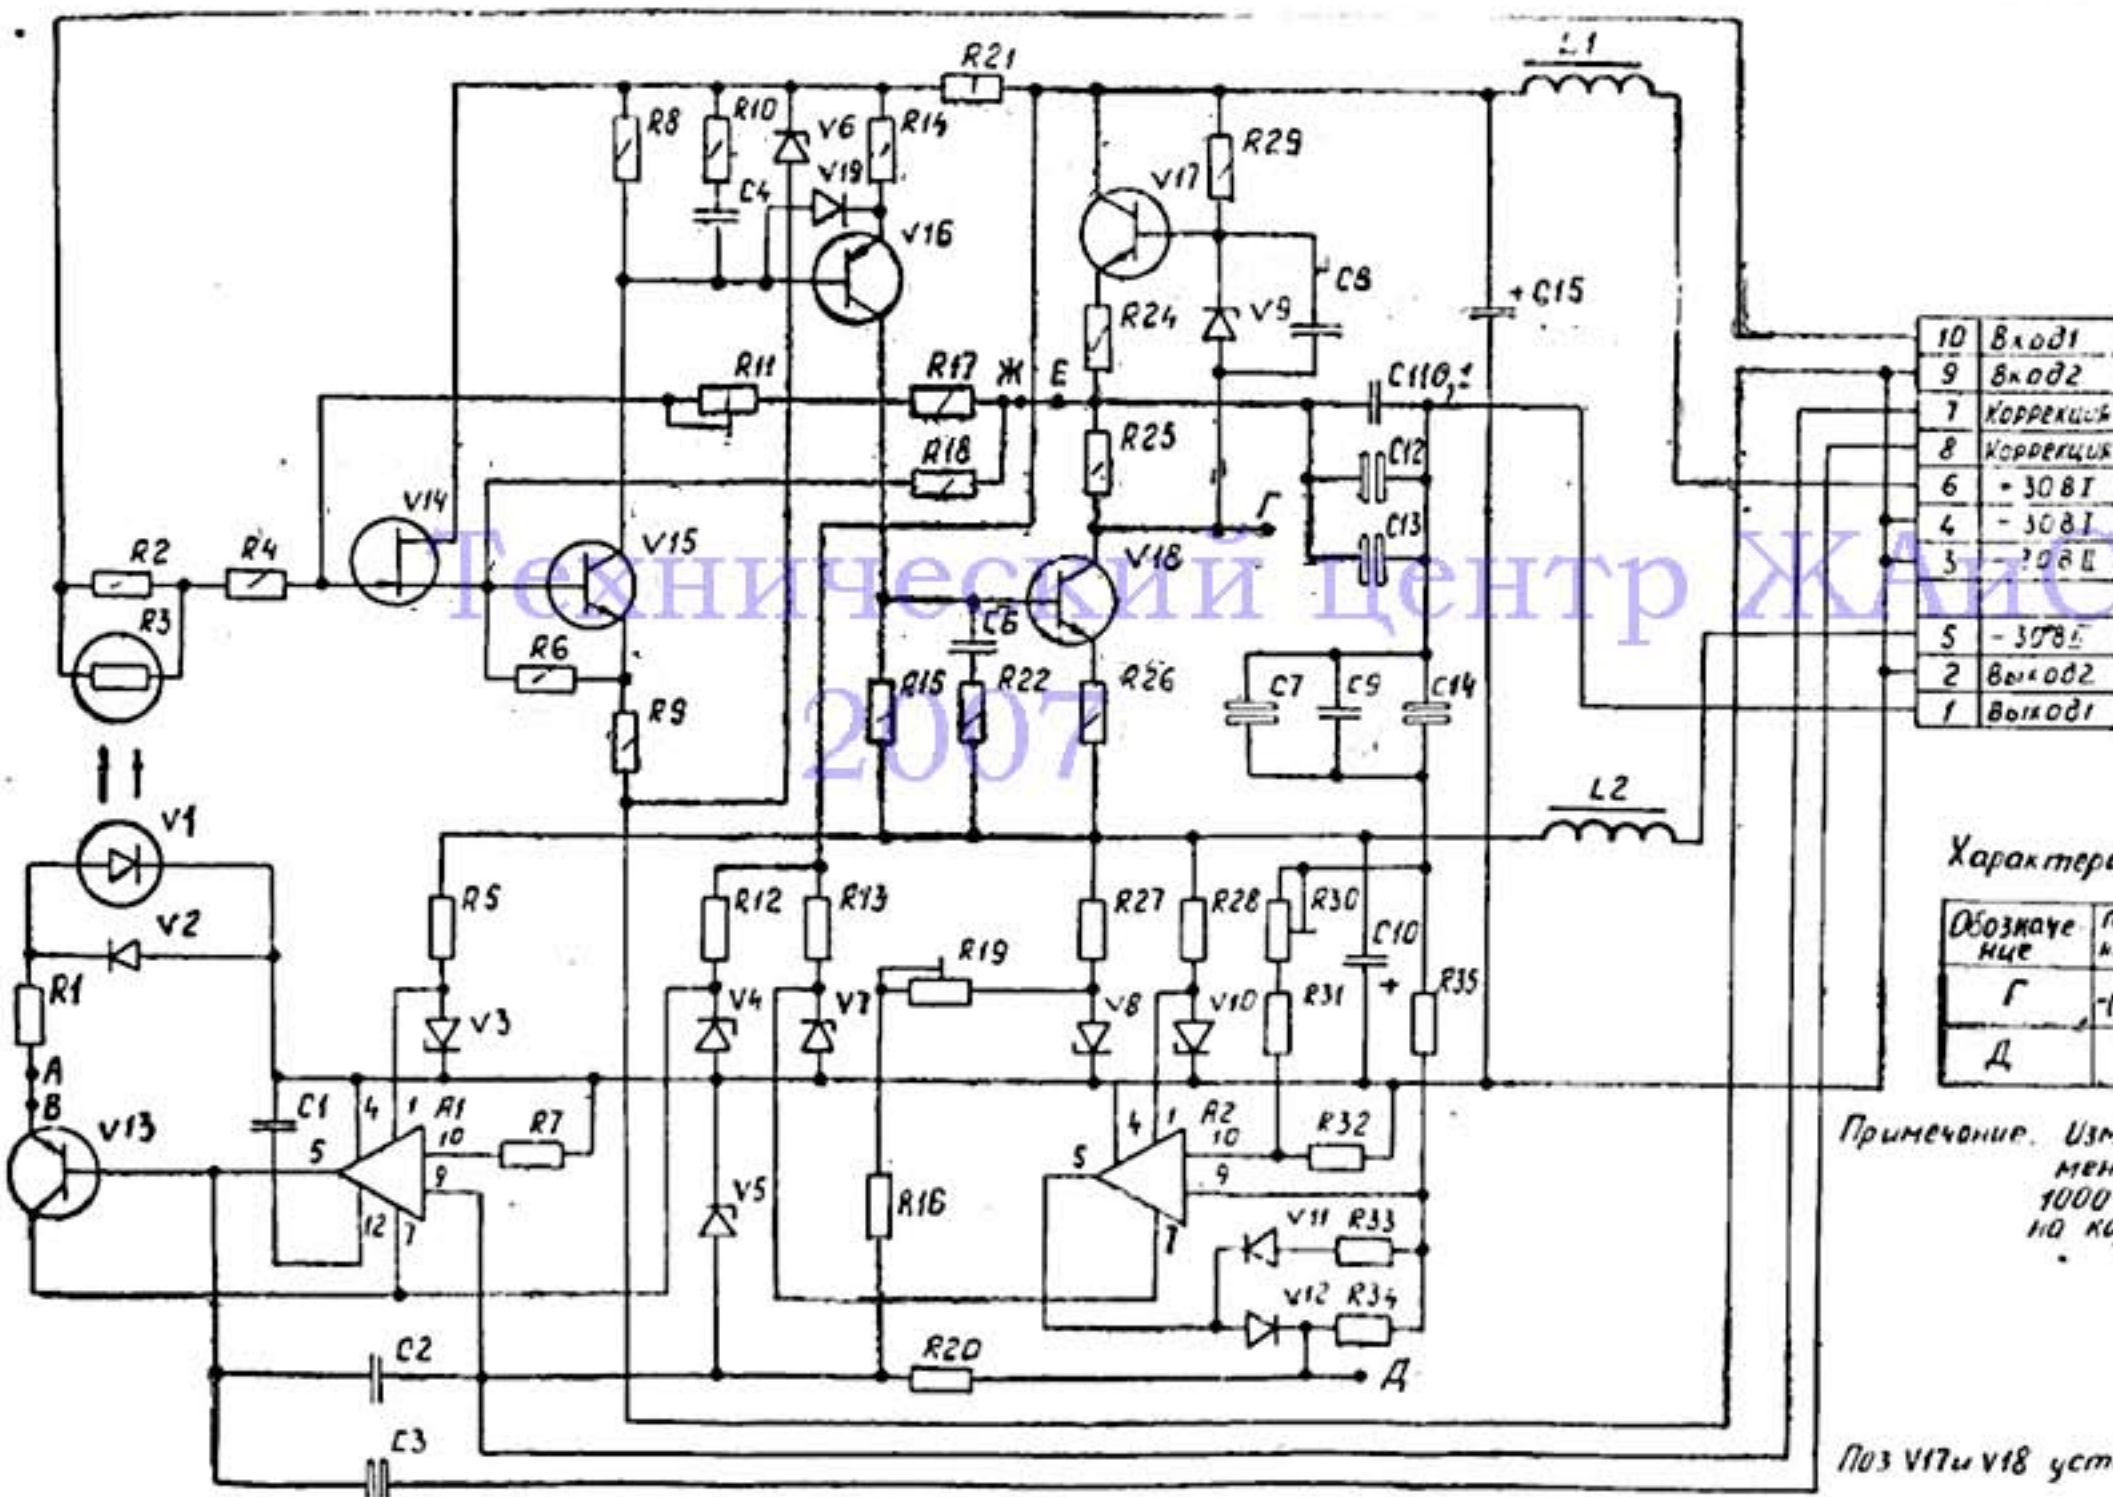

10	Вход1
9	Вход2
7	КОРРЕКЦИЯ
8	КОРРЕКЦИЯ
6	-30 ВТ
4	-30 ВТ
3	-30 ВТ
5	-30 ВТ
2	Выход2
1	Выход1

Характеристика контрольных точек

Обозначение	Постоян. напряж, В	Форма сигнала	Перемен. напряж, В
Г	-(1,2-1,8)	Поступител.	$8 \pm 0,2$
Д		Перем.	0,75-0,95

Примечание. Измерения постоянных и переменных напряжений на частоте 1000 Гц производить относительно корпуса вольтметром В7-26.

Поз V17 и V18 установлены на теплоотвод.